



**PREZES
GŁÓWNEGO URZĘDU MIAR**
Warszawa, ul. Elektoralna 2

Warszawa, 2004 -12- 3 1

DECYZJA NR ZT 374/2004

Na podstawie art. 8f ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 11 maja 2001 r. - Prawo o miarach (Dz. U. z 2004 r. Nr 243, poz. 2441) - po rozpatrzeniu wniosku z dnia 26 lipca 2004 r., nr TK/2386/04, który wpłynął do Głównego Urzędu Miar w dniu 30 lipca 2004 r., uzupełnionego pismami z dnia 3 grudnia 2004 r., nr TK/fax2438/04 i z dnia 6 grudnia 2004 r., nr TK/fax2448/04, zgłoszonego przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań oraz na podstawie wyników badań przeprowadzonych przez Główny Urząd Miar i Okręgowy Urząd Miar w Poznaniu

ZATWIERDZAM TYP

wodomierzy działających na zasadach mechanicznych, przeznaczonych do wody gorącej, o znakach fabrycznych MP130-40, MP130-40-NK, MP130-40-NKP, MP130-50, MP130-50-NK, MP130-50-NKP, MP130-65, MP130-65-NK, MP130-65-NKP, MP130-80, MP130-80-NK, MP130-80-NKP, MP130-100, MP130-100-NK, MP130-100-NKP, produkowanych przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań, zwanych dalej „wodomierzami”.

Wodomierzom nadaje się znak zatwierdzenia typu **PLT 04 154**

Wodomierze spełniają wymagania określone w rozporządzeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie wymagań metrologicznych, którym powinny odpowiadać wodomierze (Dz. U. Nr 40, poz. 360).

Charakterystyka typu:

1	2	3	4	5	6	7	
Znak producenta	-	PoWoGaz					
Znak fabryczny	-	MP130-40 MP130-40-NK MP130-40-NKP	MP130-50 MP130-50-NK MP130-50-NKP	MP130-65 MP130-65-NK MP130-65-NKP	MP130-80 MP130-80-NK MP130-80-NKP	MP130-100 MP130-100-NK MP130-100-NKP	
Średnica nominalna	mm	40	50	65	80	100	
Nominalny strumień objętości Q_n	m ³ /h	15	15	25	40	60	
Maksymalny strumień objętości Q_{max}	m ³ /h	30	30	50	80	120	
Pośredni strumień objętości Q_t	kl. B	m ³ /h	2,25	2,25	3,75	6,0	9,0
	kl. C	m ³ /h	1,5	1,5	2,5	4,0	6,0
Minimalny strumień objętości Q_{min}	kl. B	m ³ /h	0,6	0,6	1,0	1,6	2,4
	kl. C		0,3	0,3	0,5	0,8	1,2
Klasa metrologiczna – pozycja zabudowy	-	B, C/H					
Zakres wskazań	m ³	10⁶					

1	2	3	4	5	6	7
Wartość działki elementarnej	dm ³			0,5		
Maksymalna dopuszczalna temperatura	°C			130		
Górne graniczne ciśnienie	bar			16		
Maksymalna strata ciśnienia	bar			0,6		
Długość wodomierza	mm	300	200, 270, 300	300	300, 350	350, 360

Podczas legalizacji wodomierzy dopuszcza się ich sprawdzanie wodą zimną.

Wodomierze o znakach fabrycznych MP130-...-NK wyposażone są w kontaktronowy nadajnik impulsów typu NK, służący do zdalnego przekazywania sygnału.

Wodomierze o znakach fabrycznych MP130-...-NKP mogą być wyposażone w kontaktronowy nadajnik impulsów typu NK, służący do zdalnego przekazywania sygnału, podczas eksploatacji wodomierza.

Liczydłem podstawowym pozostaje liczydło mechaniczne (pierwotne).

Stała przetwarzania sygnału – 2,5 dm³/imp. albo 10 dm³/imp. albo 25 dm³/imp. albo 100 dm³/imp. albo 250 dm³/imp. albo 1000 dm³/imp.

Cechę legalizacji umieszcza się na powierzchni bocznej osłony urządzenia wskazującego.

Cechy zabezpieczające umieszcza się na:

- plombie zawieszanej na drucie lub lince przewleczonej przez otwory w łbie śruby mocującej przetwornik pomiarowy w korpusie i łbie wkrętu mocującego liczydło i urządzenie wskazujące.
- obrzeżu tabliczki znamionowej.

Wzory podzielniki i tabliczek znamionowych wodomierzy określa załącznik do decyzji.

Decyzja jest ważna do 2014 -12- 3 1

POUCZENIE

Od decyzji niniejszej stronie nie przysługuje odwołanie. Jednakże strona niezadowolona z decyzji może zwrócić się do Prezesa Głównego Urzędu Miar z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Otrzymują:

1. Fabryka Wodomierzy PoWoGaz SA
ul. K. Janickiego 23/25
60-542 Poznań
2. GUM a/a




Włodzimierz Sanocki

Do wiadomości:
Dyrektorzy OUM

egz. szt. 2


MP130-40
MP130-65
MP130-80
MP130-100



Oznaczenia:

- 1- dwie końcowe cyfry roku produkcji i numer fabryczny
- 2- znak zatwierdzenia typu

MP130-40-NK
MP130-40-NKP
MP130-50-NK
MP130-50-NKP
MP130-65-NK
MP130-65-NKP
MP130-80-NK
MP130-80-NKP
MP130-100-NK
MP130-100-NKP

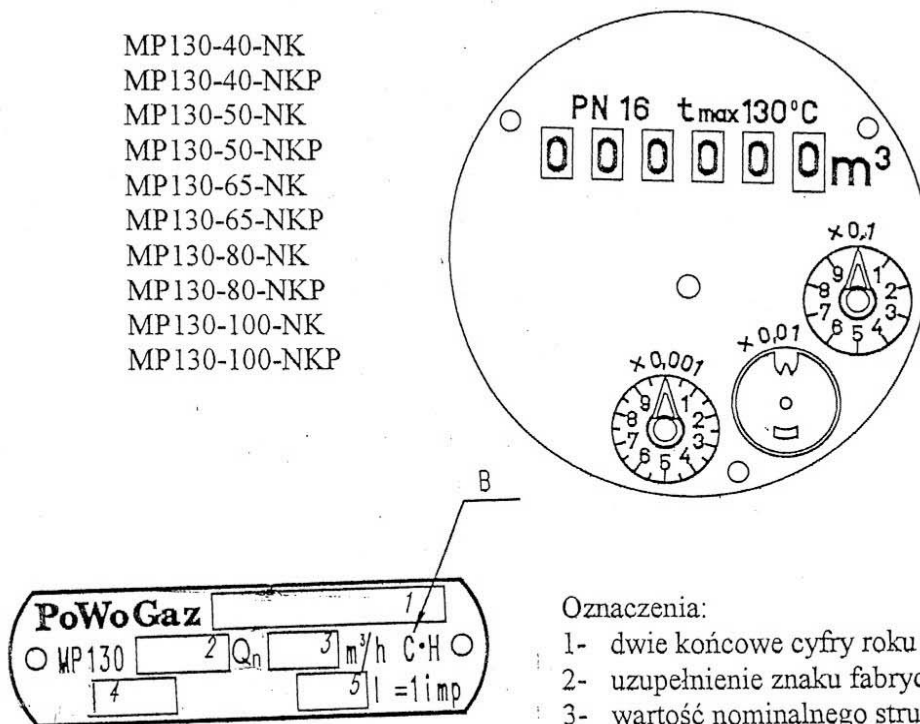

Oznaczenia:

- 1- dwie końcowe cyfry roku produkcji i numer fabryczny
- 2- uzupełnienie znaku fabrycznego
- 3- wartość nominalnego strumienia objętości
- 4- znak zatwierdzenia typu
- 5- stała przetwarzania sygnału

Wzory podzieln i tabliczek znamionowych wodomierzy do wody gorącej o znakach fabrycznych MP130-....., MP130-.....-NK i MP130-.....NKP, produkowanych przez Fabrykę Wodomierzy PoWoGaz S.A., ul. K. Janickiego 23/25, 60-542 Poznań.